



# Qualification des performances

## de vos équipements de traitement des dispositifs médicaux

### Endoscopie

Nos prestations sont réalisées en conformité avec l'instruction DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 et les normes ISO 15883 et EN 16442.



Laveur Désinfecteur d'Endoscopes




Enceinte de Stockage des Endoscopes Thermosensibles

### Stérilisation



Laveur Désinfecteur d'Instruments



Stérilisateurs à vapeur d'eau



Stérilisateurs basse température



Thermosoudeuses, Bacs ultrasons et Enceintes climatiques

#### Nos atouts de leader dans le domaine de l'hygiène hospitalière



Prestations recommandées par les constructeurs



Plus de 213 établissements\* nous font déjà confiance  
\*Sur l'année 2023



Qualifications annuelles en suivant les référentiels normatifs en vigueur




Couverture nationale



Prestations de conseils par nos experts

# Besoin d'un devis ?

Vos interlocuteurs commerciaux

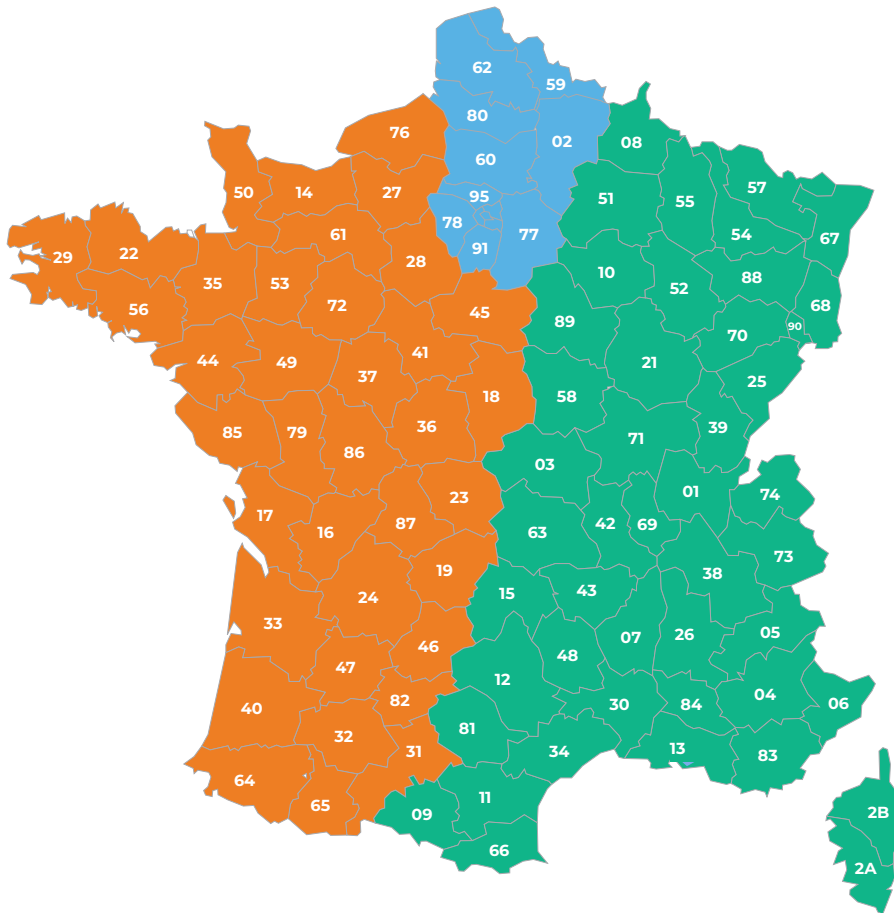

● **Eurofins  
ALPABIO**

**Mickael BONJOUR**

✉ [MickaelBonjour@eurofins.com](mailto:MickaelBonjour@eurofins.com)

☎ 06 19 02 98 58

● **Eurofins Hygiène  
Hospitalière Sud**

**Raphael BENAMAR**

✉ [RaphaelBenamar@etfr.eurofins.com](mailto:RaphaelBenamar@etfr.eurofins.com)

☎ 06 10 14 10 36

● **Eurofins Hygiène  
Hospitalière Nord**

**Elise MERCIER**

✉ [EliseMercier@etfr.eurofins.com](mailto:EliseMercier@etfr.eurofins.com)

☎ 06 47 45 69 46



**Contact général :**

[HygieneHospitaliere@eurofins.com](mailto:HygieneHospitaliere@eurofins.com)